


多功能全光譜分析儀---儀器應用介紹&實機示範



SpectraMax M5

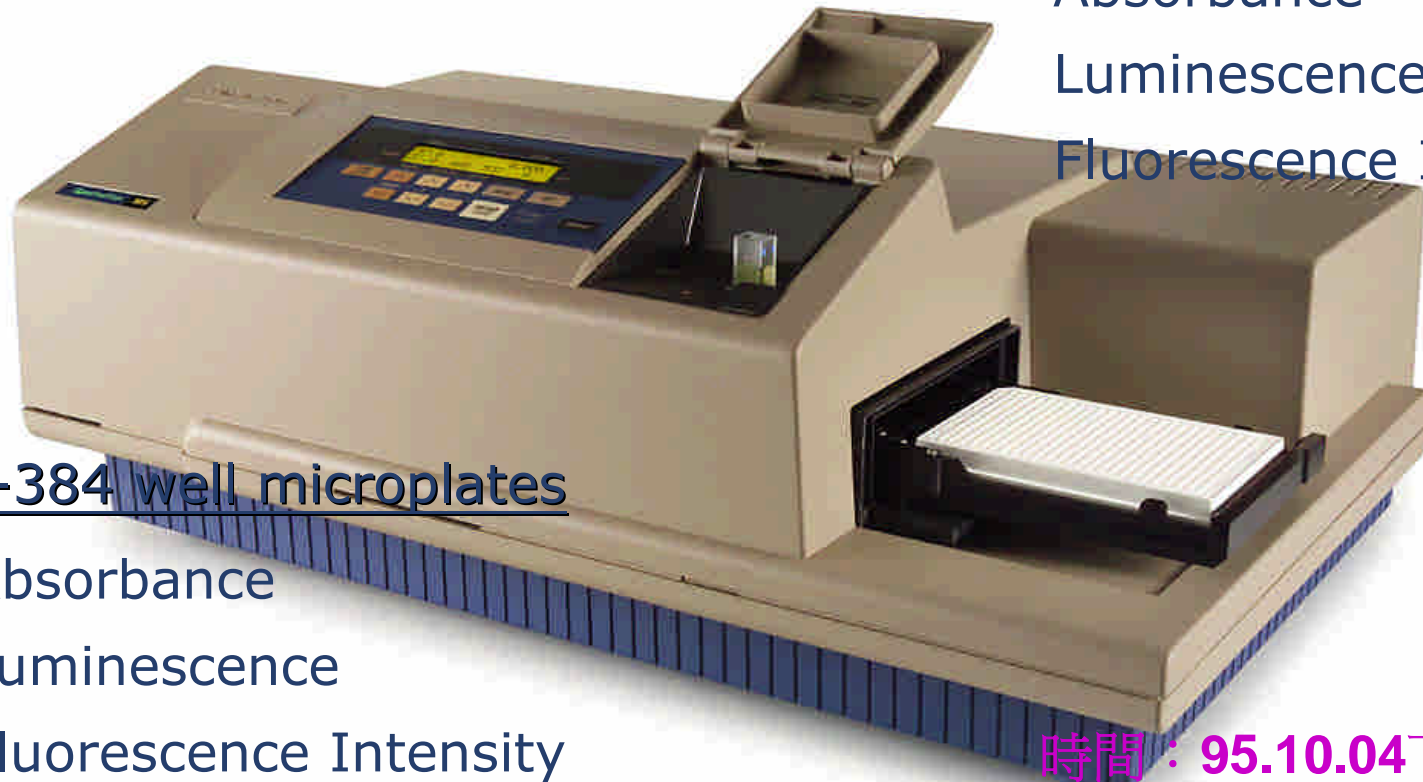

Cuvette port

Absorbance

Luminescence

Fluorescence Intensity

6-384 well microplates

Absorbance

Luminescence

Fluorescence Intensity

Fluorescence Polarization

Time-resolved Fluorescence

時間：95.10.04下午03:00

地點：立夫教學大樓 101講堂

協辦單位：科羅耐國際科技